


EM=226

LCMS Scan ESI+

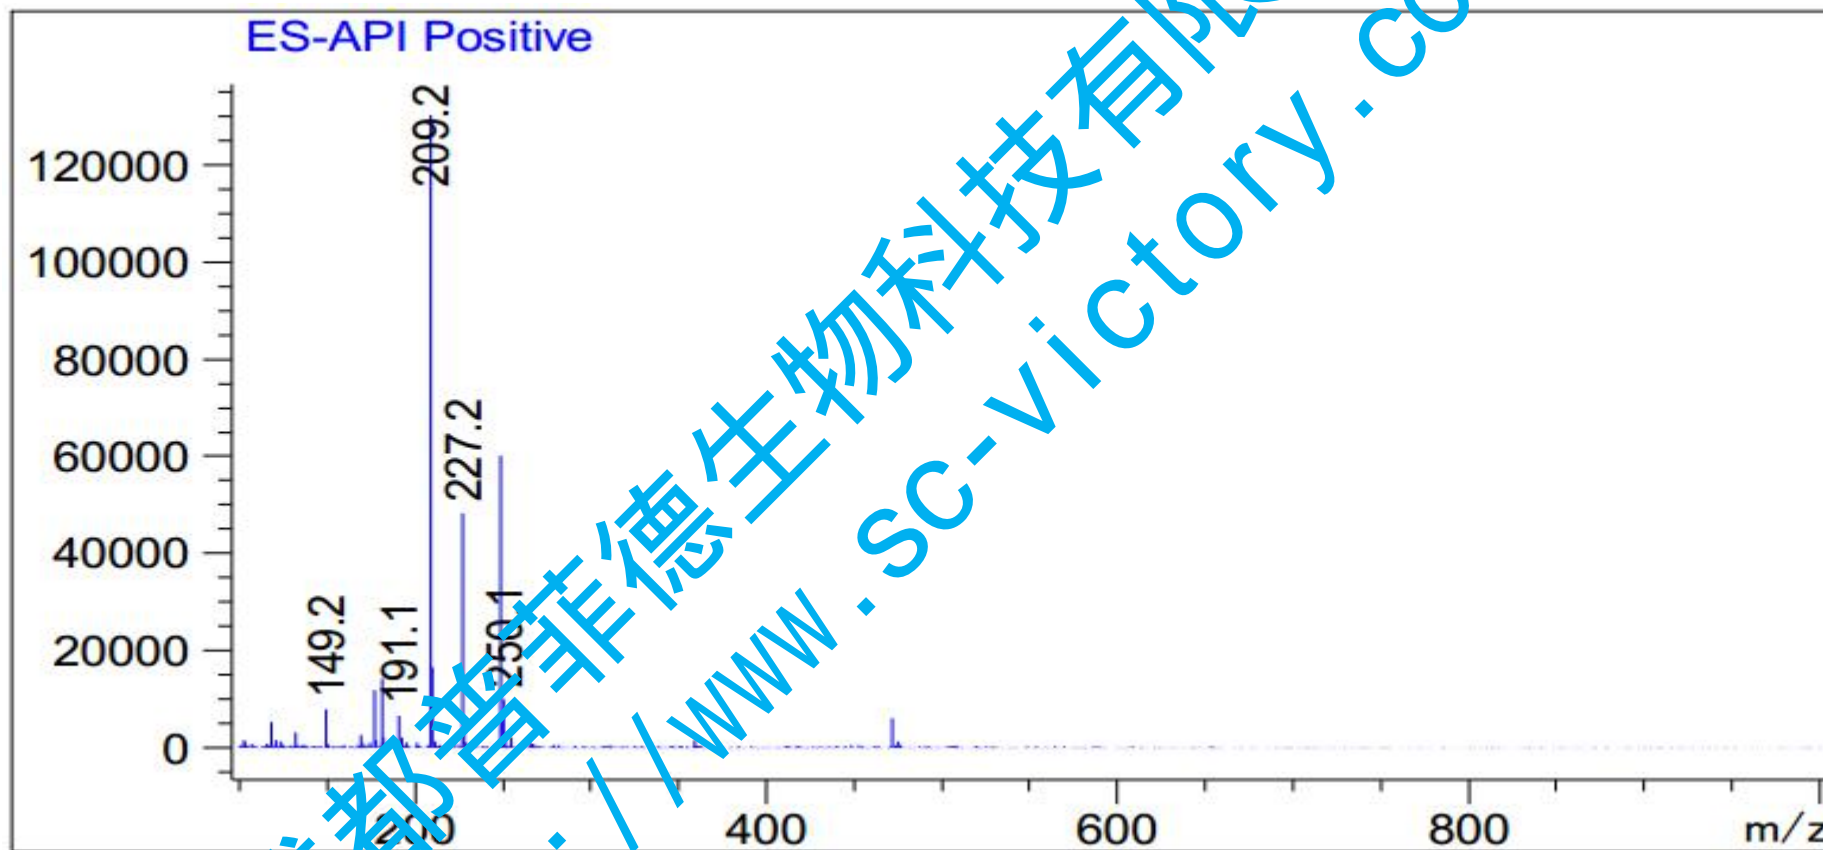

成都普菲德生物科技有限公司
<http://www.sc-victory.com>

EM=226

LCMS Scan ESI-

Ret. Time: 2.34 <<<< NEGATIVE SPECTRA >>>>

